

► Lesen und befolgen Sie bei Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen zuerst die

Besondere Bedingungen und Hinweise für die sichere Anwendung

in den beigefügten

Explosionsschutz-Informationen

und beachten Sie die Betriebsanleitung.

Die Verbindung der einzelnen Komponenten wie z.B. Messflügel, Knickschutz, Wellen-Verlängerung und Pendelwelle ist nur mit den beigefügten Stiften zulässig.


Betriebsanleitung

1. Beschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der elektromechanische Füllstand-Grenzschalter überwacht den Füllstand von Schüttgütern in Silos, Bunker, Behälter, Trichter, usw..

1.2 Geräteaufbau

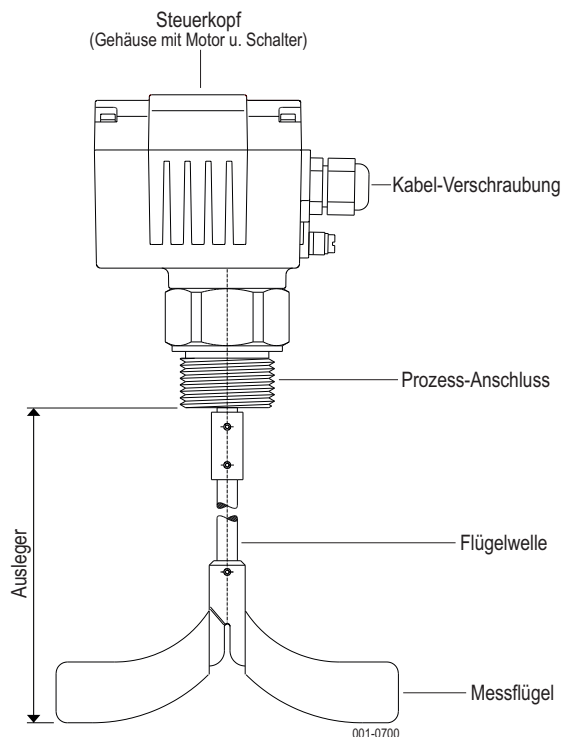

1.3 Funktion

Der in den Behälter ragende, rotierende Messflügel wird von einem Getriebemotor angetrieben.

Erreicht Füllgut den Flügel, wird dieser an seiner Drehung gehindert und angehalten.

Das Rückdrehmoment dreht den drehbar gelagerten Motor aus seiner Endlage und betätigt den Signal-Schalter. Ein zweiter Schalter schaltet den Motor aus.

Sinkt der Füllstand und der Messflügel wird frei, bewegt eine Feder den Motor in seine ursprüngliche Endlage. Dabei wird der Motor wieder eingeschaltet und der Signal-Schalter zurückgeschaltet.

1.4 Technische Daten

Hersteller	MOLLET
Anschrift	Füllstandtechnik GmbH Industriepark RIO 103 74706 Osterburken
Benennung	Drehflügel- Füllstandanzeiger
Typ	DF
Schüttguttemperatur	T_s -25 °C ... +80 °C
Umgebungstemperatur	T_a -20 °C ... +70 °C
Druckbereich	p -0,5 bar ... +1 bar
Messflügeldrehzahl	1 U/min
Ansprechverzögerung	ca. 1,20 sec.
Wartung	keine

1.5 Werkstoffe

Gehäuse	Aluminium
Prozess-Anschluss	Aluminium
Flügelwelle	Edelstahl
Messflügel	Edelstahl
Messflügel TK	Kunststoff


2. Montage

2.1 Vorbereitung

- Lesen und befolgen Sie vor den Arbeiten am Gerät die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung !
- Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit. Der Lieferumfang ist je nach Ausstattung unterschiedlich.


2.2 Einbau

- Setzen Sie den Füllstandanzeiger mit der Dichtung an der vorgesehenen Stelle in die Behälterwand und schrauben Sie ihn mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges fest.

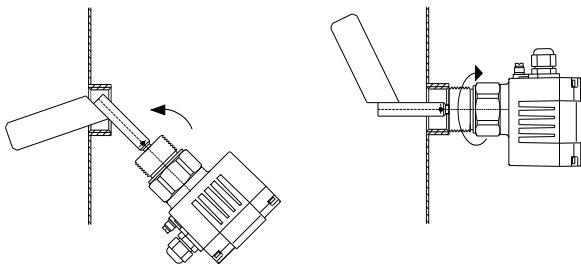


Achtung!

Im Gewindestutzen darf sich kein Schüttgut ablagern.

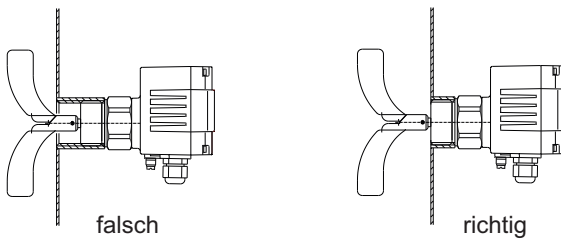


Bauen Sie den Füllstandanzeiger so ein, dass der Ausleger nicht vom Befüllstrom getroffen wird.

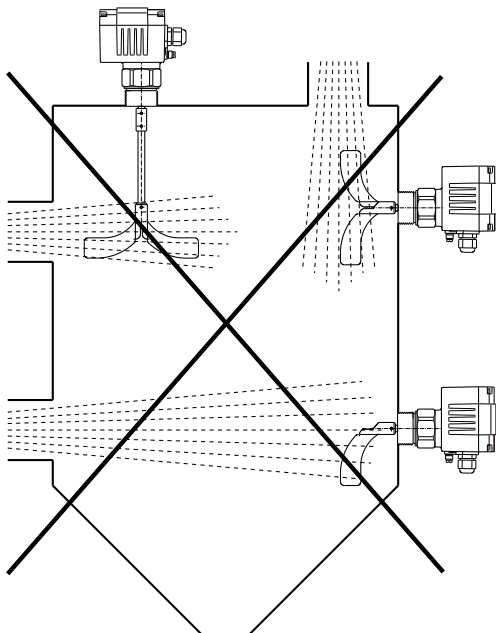


2.3 Gehäuse ausrichten

- Richten Sie nach dem Einbau das Gehäuse durch verdrehen so aus, dass die Kabelverschraubung bei senkrechtem Einbau in die Richtung des Kabelkanales und bei allen anderen Einbaulagen senkrecht nach unten zeigt.

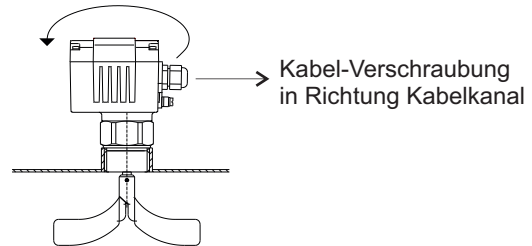


Achtung!

Auf dichten Sitz des Kabels in der Verschraubung ist unbedingt zu achten.

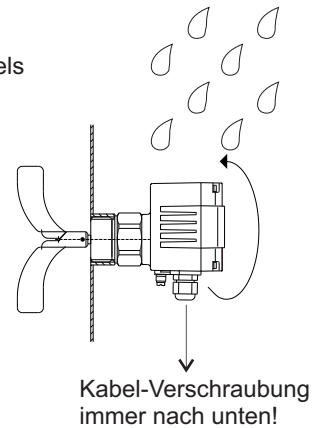


3. Montage der Messflügel - bei ATEX-Ausführung nur Spannstifte und keine Splinte verwenden!


TK Flügel

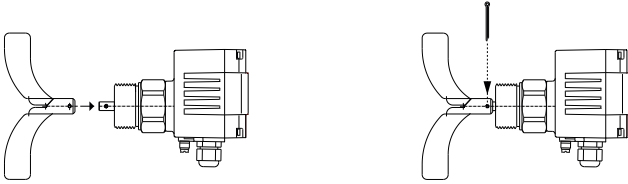


Bei Einsatz als Leermelder wird empfohlen, den Flügel auf der einen Seite, entlang der Kerbe, abzusägen und bei starker Flügelbelastung wird zusätzlich der Einbau von einem Schutzdach empfohlen.

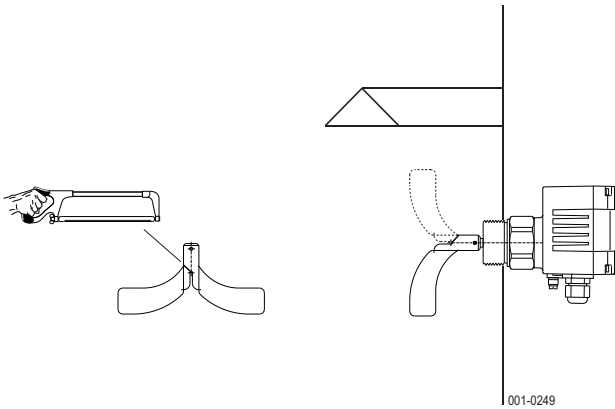


TD Flügel

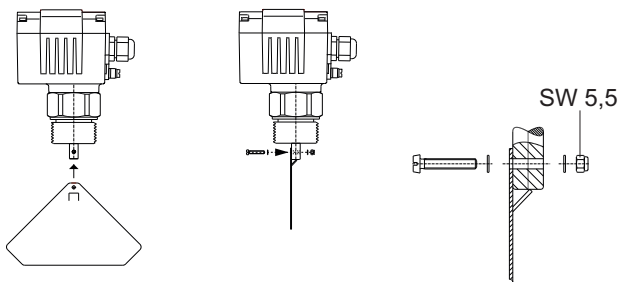


Achtung!
Stützen Sie die Welle während dem Einschlagen des Stiftes mit einem geeigneten Gegenlager ab.

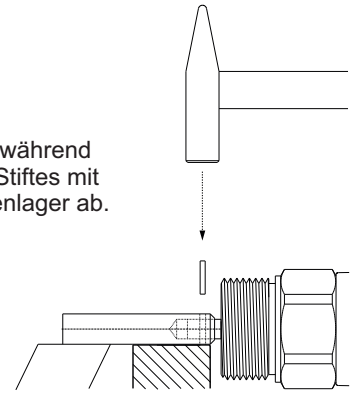

S1 Muffen-Flügel

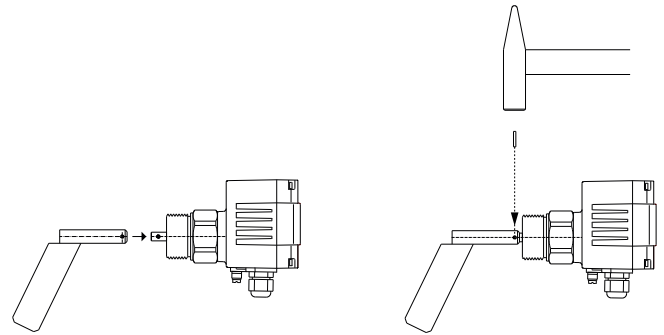


X Flügel

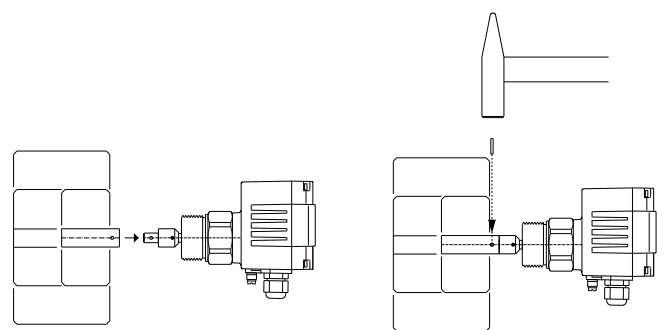

4. Belastbarkeit der Messflügel


F_1 max. **50 Nm**




001-0702

5. Montage der Ausleger-Verlängerung - bei ATEX-Ausführung nur Spannstifte und keine Splinte verwenden!


W1 Fest-Welle

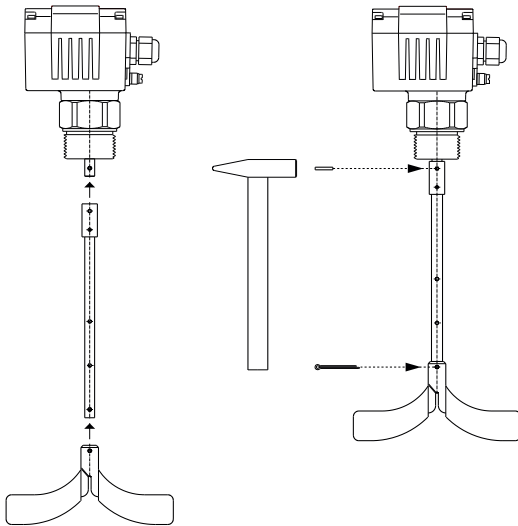

W6 Seil-Welle

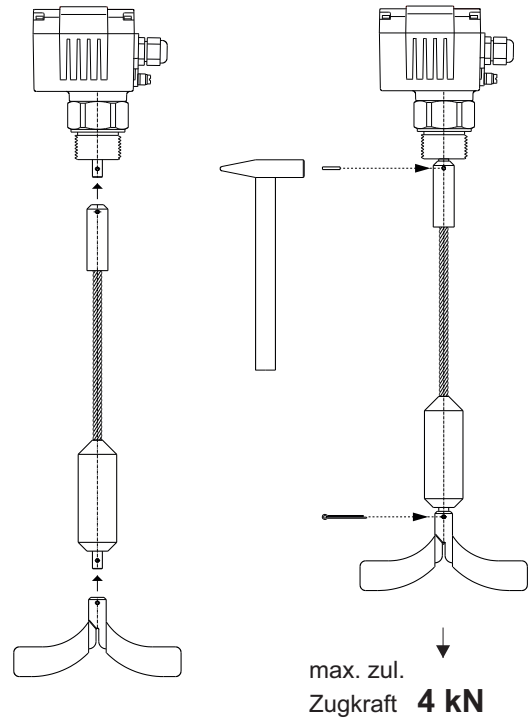

W3/W4 Pendel-Welle

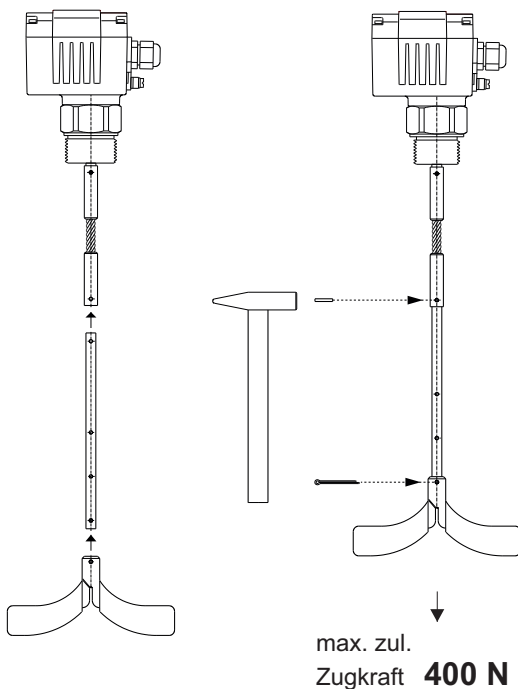


Seil kürzen

Bei Bedarf können Sie die Seil-Welle individuell kürzen.

- Lösen Sie die Klemmschrauben am Straffgewicht und ziehen Sie das Straffgewicht vom Seil.
- Umwickeln sie das Seil an der gewünschten Trennstelle mit Klebeband zum Schutz vor abspringenden Drahtstücken.
- Setzen Sie eine Schutzbrille auf und durchtrennen Sie das Seil mit einer Kabelschere oder einem Winkelschleifer.
- Entfernen Sie das Klebeband und montieren Sie das Straffgewicht auf das Seilende.

Achtung!

Stützen Sie die Welle während dem Einschlagen des Stiftes mit einem geeigneten Gegenlager ab.

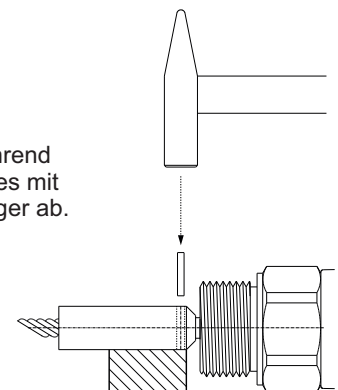

6. Elektrischer Anschluss

6.1 Elektrische Daten

Betriebsspannung	siehe Typenschild
Leistungsaufnahme	supply AC 4 VA DC 4 W
Kabeleinführung	Verschraubung M20 x 1,5
Schutzart	IP IP 66 nach DIN 60529
Anschlussklemmen	max. 1,5 mm ²
Signal-Kontakt	potenzialfreier Wechsler
Schaltspannung	Contact 4 V DC ... 250 V AC
Schaltvermögen	1mA ... 2A

Der Signal-Kontakt ist ein Mehrspannungs- und Mehrstromschalter. Er ist geeignet für den Einsatz in Schaltkreisen mit geringen Strömen und geringen Spannungen sowie auch für mittlere Ströme bei Steuerspannungen bis 250 V.

Achtung!

Der Schalter darf während seiner gesamten Verwendungsdauer nur in ein und demselben Schaltkreistyp eingesetzt werden. Sobald der Schalter einmal mit mittlerer Schaltleistung betrieben wurde, kann er nicht mehr für die niedrige Schaltleistung eingesetzt werden


6.2 Anschluss

- Führen Sie den elektrischen Anschluss gemäß den Anschlussplänen aus.
- Verlegen Sie die Kabel zwischen Gehäuse und Kabelschutz, damit der Motor und die Schalter nicht an ihrer notwendigen Bewegung gehindert werden können.
- Drehen Sie nach dem elektrischen Anschluss die Überwurfmutter der Kabelverschraubung fest und achten Sie darauf, dass das Kabel dicht und fest in der Verschraubung sitzt.


Achtung!

Füllstandanzeiger immer so ansteuern, dass bei Netzausfall keine unerwünschte Schaltfunktion erfolgen kann.


6.3 Anschlussplan AC

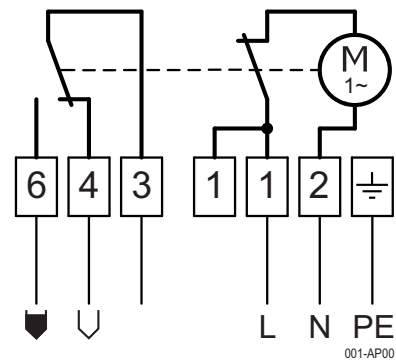

6.4 Anschlussplan DC

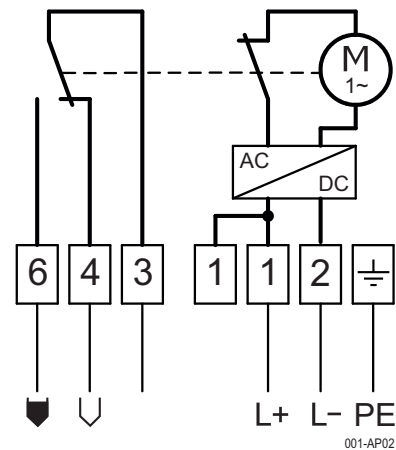


6.5 Schaltlogik

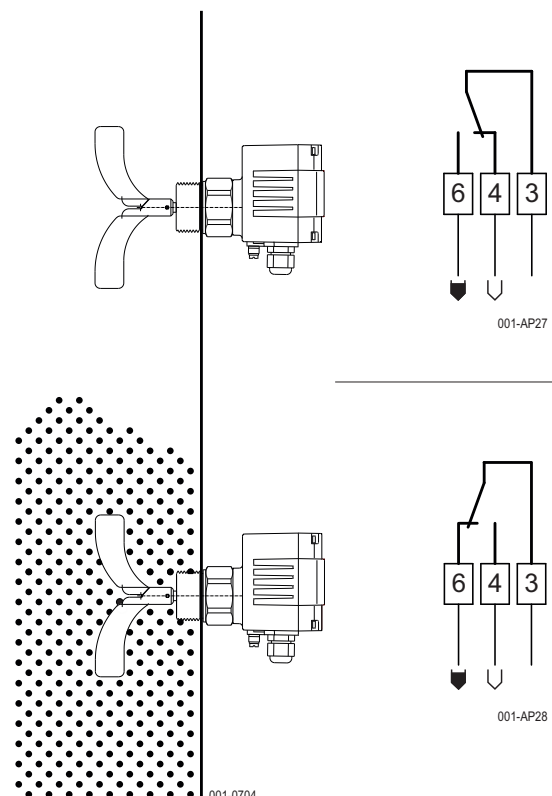

7. Einstellen der Empfindlichkeit

Bei Bedarf können Sie durch Umsetzen des Federarmes die Empfindlichkeit des Füllstandanzeigers den Eigenschaften des Schüttgutes anpassen.

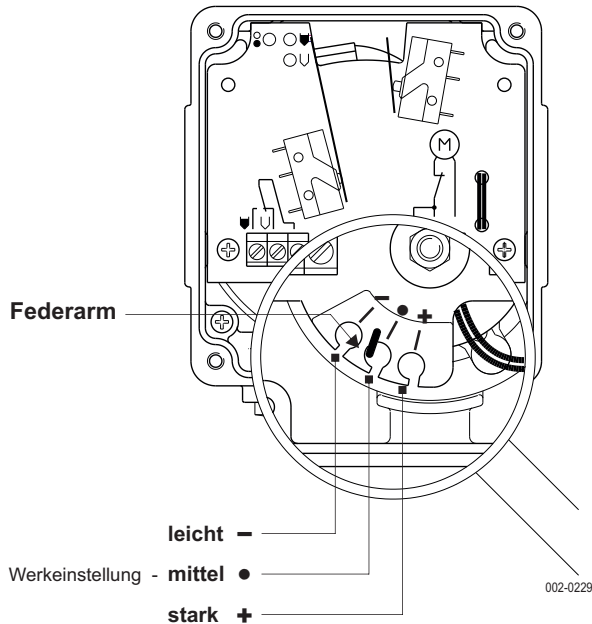

Drei Einstellungen sind möglich:

1. **leicht** für sehr leichte Schüttgüter
2. **mittel** für fast alle Schüttgüter geeignet
3. **stark** für anbackende Schüttgüter

Fluidisiertes Schüttgut während der Befüllung und der Austragung ist leichter. Dies muss bei der Einstellung der Federkraft und der Auswahl der Flügelgröße entsprechend berücksichtigt werden.

8. Benutzung

8.1 Inbetriebnahme

- Nehmen Sie den Drehflügel-Füllstandanzeiger erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß eingebaut und mit dem elektrischen Anschluss fest verbunden ist.
- Während dem Betrieb muss das Gehäuse und die Kabeleinführung dicht verschlossen sein.

8.2 Normalbetrieb

- Betreiben Sie den Drehflügel-Füllstandanzeiger nur in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Betreiben Sie den Füllstandanzeiger nur innerhalb der angegebenen Temperaturbereiche für die Umgebungs- und Schüttguttemperatur.
- Schützen Sie den Innenraum des Steuerkopfes vor Verschmutzung.
- Wird der Füllstandanzeiger beschädigt, nehmen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb.

8.3 Unsachgemäße Verwendung

- Nicht beachten der Sicherheitshinweise und der Betriebsanleitung.
- Betrieb des Drehflügel-Füllstandanzeiger in nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
- Einbau von Ersatzteilen, die keine Originalteile sind.
- Entfernen, hinzufügen oder verändern von Bauteilen, sofern dies nicht in den Unterlagen des Herstellers beschrieben ist.
- Verstoß gegen geltende Normen und Gesetze.

9. Wartung und Instandsetzung

9.1 Wartung

- Der Drehflügel-Füllstandanzeiger ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung wartungsfrei.
- Entfernen Sie Ablagerungen an den Flügeln oder Wellen mit einer Bürste oder einem Schaber. Wenden Sie dabei keine Gewalt an und beschädigen Sie nicht den Wellendichtring.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Teile im Behälter auf Verschleiß. Legen Sie dabei die Abstände der Prüfungen in Abhängigkeit der Schüttguteigenschaften fest.

9.2 Instandsetzung

- Schadhafte Teile, Anschlüsse oder Verbindungen müssen umgehend instandgesetzt oder durch gleichartige ersetzt werden.
- Der Drehflügel-Füllstandanzeiger darf bis zur vollständigen Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Funktion nicht mehr benutzt werden.


10. Lagerung

- Lagern Sie den Füllstandanzeiger an einem vor Feuchtigkeit und Staub geschützten Ort.
- Achten Sie bei Füllstandanzeiger mit Ausleger-Verlängerung darauf, dass die Welle nicht geknickt oder verbogen wird.


11. Entsorgung

- Der Füllstandanzeiger kann dem Recycling zugeführt werden.
- Für die Entsorgung gelten die für die Produktionsbedingungen und den Standort des Betreibers gültigen Umweltrichtlinien.

Abmessungen

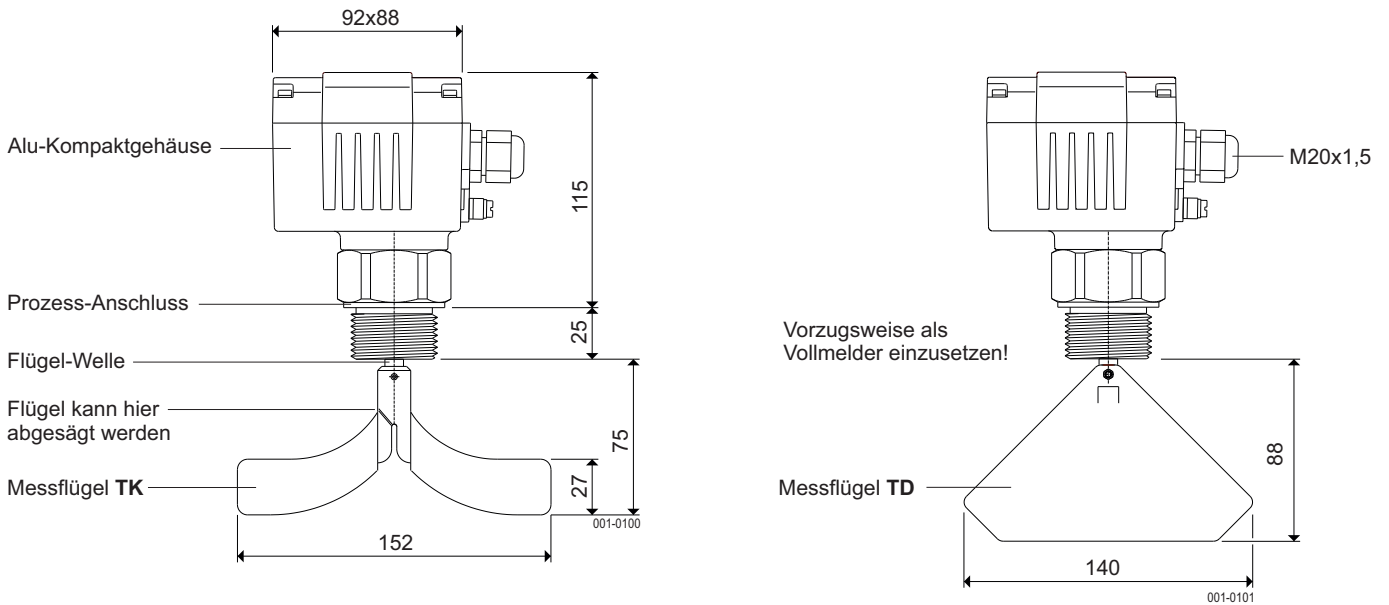


Bei Verwendung als Leermelder empfehlen wir den Flügel einseitig abzusägen

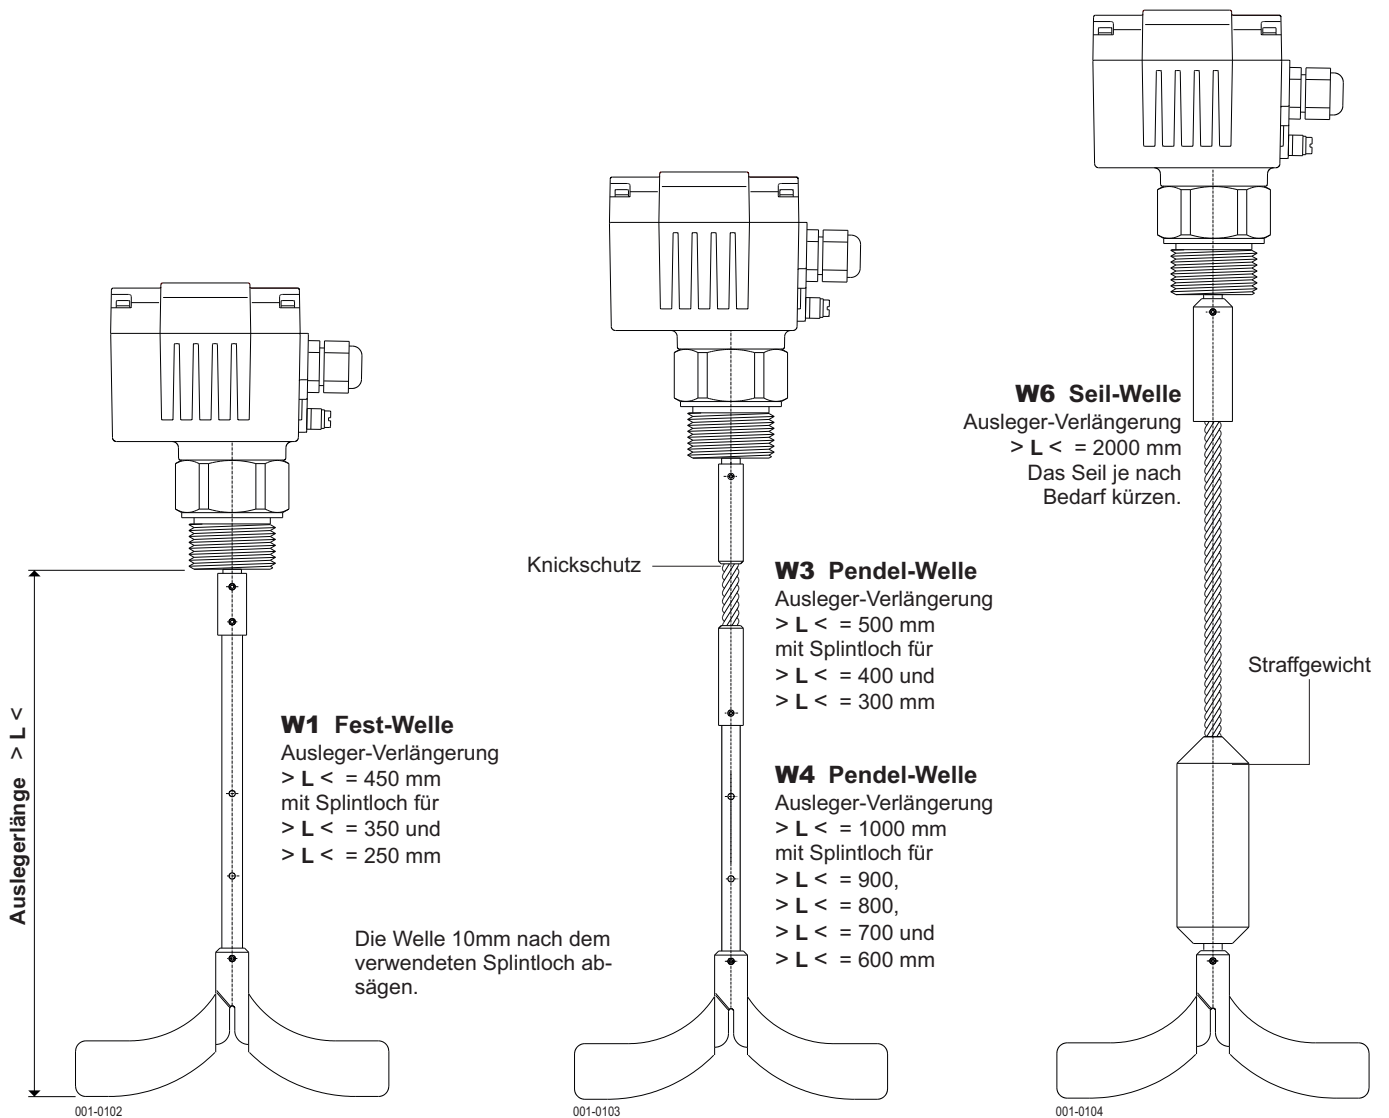


Abmessungen der Messflügel

TK Flügel

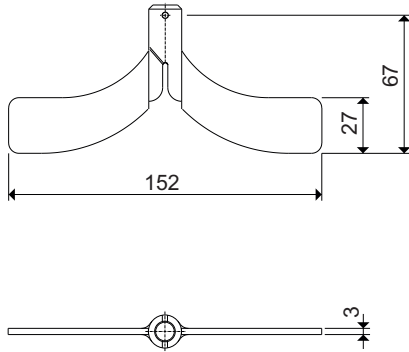


TK3 Flügel

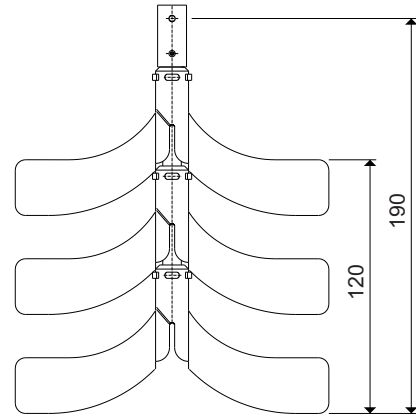


Ex-Info
Der Messflügel TK ... darf nicht in Behälter eingesetzt werden, die mit einer pneumatischen Fördereinrichtung befüllt werden.


TD Flügel

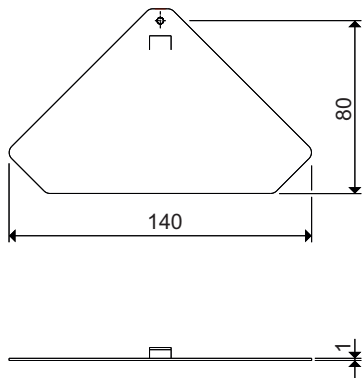

S1 Muffen-Flügel

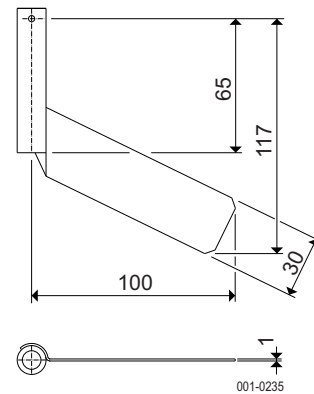

X Flügel

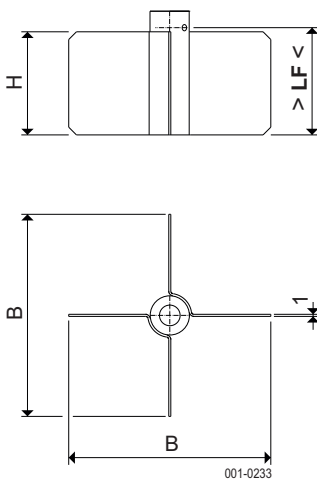

Geringste Schüttdichte bis zu der der Messflügel eingesetzt werden kann.

Schüttdichte Q_{SS} in

Füllhöhe bis 100mm oberhalb vom Messflügel	kg/l	t/m ³
Füllhöhe bis Messflügel vollständig bedeckt	t/m ³	kg/l

Messflügel	Flügel-Größe	Federkraft-Einstellung	
		leicht	mittel
S1 Muffen-Flügel	100x30	$\frac{0,25}{0,4}$	$\frac{0,35}{0,6}$
TK Flügel TK150	150x27	$\frac{0,25}{0,4}$	$\frac{0,35}{0,6}$
TK3 3 Flügel TK150	150x120	$\frac{0,15}{0,2}$	$\frac{0,2}{0,3}$
TD Flügel TD140	140x85	$\frac{0,2}{0,4}$	$\frac{0,3}{0,5}$
X1 Flügel X50	98x50	$\frac{0,15}{0,3}$	$\frac{0,25}{0,5}$
X2 Flügel X100	98x100	$\frac{0,1}{0,2}$	$\frac{0,2}{0,45}$
X3 Flügel X200	180x100	$\frac{0,025}{0,05}$	$\frac{0,075}{0,15}$


Alle Angaben sind Richtwerte!

	B	H	LF
X1	98	50	52
X2	98	100	102
X3	180	100	102




Planungsinformation

Rohrgewinde EN ISO 228-1

DIN ISO 228-1 (ersetzt DIN 259)

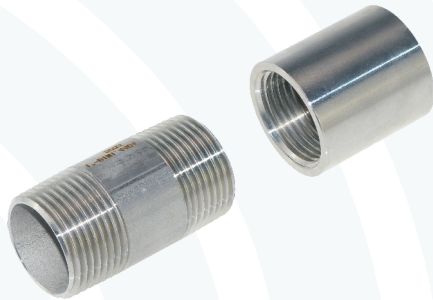

Gewinde G	Außen Ø mm	Mutterinnen Ø mm	Kernloch Ø mm	Gänge je Insch	Steigung mm
G 1/8	9,73	8,85	8,80	28	0,907
G 1/4	13,16	11,89	11,80	19	1,337
G 3/8	16,66	15,39	15,25	19	1,337
G 1/2	20,95	19,17	19,00	14	1,814
G 3/4	26,44	24,66	24,50	14	1,814
G 1	33,25	30,93	30,75	11	2,309
G 1 1/4	41,91	39,59	39,25	11	2,309
G 1 1/2	47,80	45,48	45,25	11	2,309
G 2	59,61	57,29	57,00	11	2,309
G 2 1/2	75,18	72,86	72,60	11	2,309
G 3	87,88	85,56	85,30	11	2,309
G 3 1/2	100,33	98,01	97,70	11	2,309
G 4	113,03	110,71	110,40	11	2,309
G 4 1/2	125,73	123,41	123,10	11	2,309
G 5	138,43	136,11	135,70	11	2,309
G 6	163,83	161,51	161,20	11	2,309

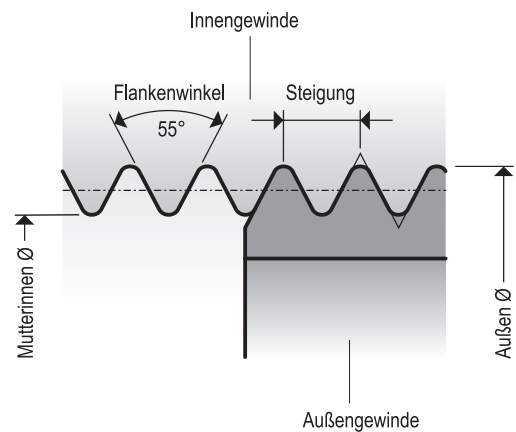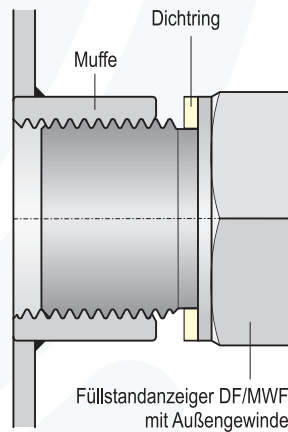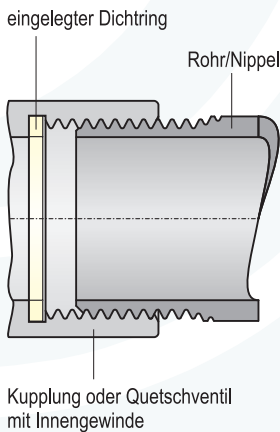

Alle von MOLLET gelieferten Kupplungen und Quetschventile werden für **nicht** im Gewinde dichtende Verbindungen (zylindrisch) hergestellt.

Ebenso die Füllstandanzeiger DF und MWF.

Die Dichtheit wird durch Dichtringe erreicht.

Kann aber auch zum Beispiel mit O-Ringen oder Dichtkleber hergestellt werden.



Laut Maßtabelle haben Gewinde nach DIN ISO 228-1 (ersetzt DIN 259) und EN 10226-1 (ersetzt DIN 2999) die selben Maßwerte, jedoch sind die Toleranzen nach EN 10226-1 beim Innendurchmesser im unteren Bereich und beim Außendurchmesser im oberen Toleranzbereich.

Es kommt daher vor, dass zylindrische Außengewinde nach DIN ISO 228-1 sich nicht in Teile (Muffen) einschrauben lassen, deren Innengewinde nach EN 10226-1 gefertigt sind.

EU-Konformitätserklärung

EU-Declaration of Conformity

Wir/We

MOLLET Füllstandtechnik GmbHIndustriepark RIO 103
D-74706 Osterburken
Tel. 06291 64400 Fax 06291 9846erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:
declares under our sole responsibility, that the product:**Drehflügel-Füllstand-Grenzscharter / Rotary blade limit switch**
Drehflügel-Füllstandanzeiger / Rotary blade level indicatorTyp/Type **DF ...**den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht:
conforms with the following European directives:**EMV-Richtlinie** **EMC directive** **2014/30/EU****Niederspannungsrichtlinie** **Low voltage directive** **2014/35/EU**Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
Applied harmonized standards or normative documents**DIN EN 61326-1:2013** **DIN EN IEC 61000-6-2:2019****DIN EN 61010-1:2020** **DIN EN 60529:2014**Und die Geräte mit  - Kennzeichnung entsprechen zusätzlich der folgenden Europäischen Richtlinie:
And the devices with  - marking conform additional with the following European directive:**ATEX-Richtlinie** **ATEX directive** **2014/34/EU**Je nach Ausführungsvariante angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
Depending on the design applied harmonized standards or normative documents:**DIN EN 1127-1:2019** **DIN EN ISO 80079-36:2016** **DIN EN ISO 80079-37:2016**
DIN EN IEC 60079-0:2019 **DIN EN 60079-1:2015** **DIN EN 60079-7:2016**
DIN EN 60079-31:2014EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer:
EU-Type Examination Certificate:**IBExU04ATEX1001X**
IBExU04ATEX1010X
IBExU04ATEX1033X
IBExU04ATEX1034Ausgestellt von:.
Issued by:

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, 09599 Freiberg (0637)

Qualitätssicherung:
Quality assurance:

TÜV NORD CERT GmbH, 30159 Hannover (0044)

Osterburken, den 03.03.2020,

**Wolfgang Hageleit**
Geschäftsführer / Managing directorDiese Erklärung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
This declaration is only allowed to hand out in unchanged form.